

KLASA: UP/I-960-03/04-07/11
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 13. travnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: AB-S...
 - proizvođač mjerila: METTLER TOLEDO AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Greifensee, Švicarska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-1-1001
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka METTLER-TOLEDO d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 10. veljače 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Mettler-Toledo d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, Mandlova 3
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/13

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO AG
MJERILO: Elektromehanička vaga tip AB-S...

Službena oznaka tipa:
HR M-1-1001

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I- 960-03/95-04/89, URBROJ:558-03/9-95-5, od 07. lipnja 1995. i dopunama tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/98-07/86, URBROJ:558-03/9-99-1, od 28. travnja 1999. i KLASA:UP/I- 960-03/00-07/106, URBROJ:558-03/9-00-2, od 20. studenoga 2000., pod službenom oznakom HR M -1 -1001.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

TIP	AB-S...	
Tazred točnosti	I	
Max (g)	320	220
e ≥	1mg	1mg
d=	e=d, e=10d	e=d, e=10d, e= 100d
n≤	320 000	220 000
Temperaturno područje	12,5°C/27,5°C	10 °C /30 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage tipa AB-S te način ovjere

3. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnih odobrenja.


PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/13

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-1-1001

Slika 1

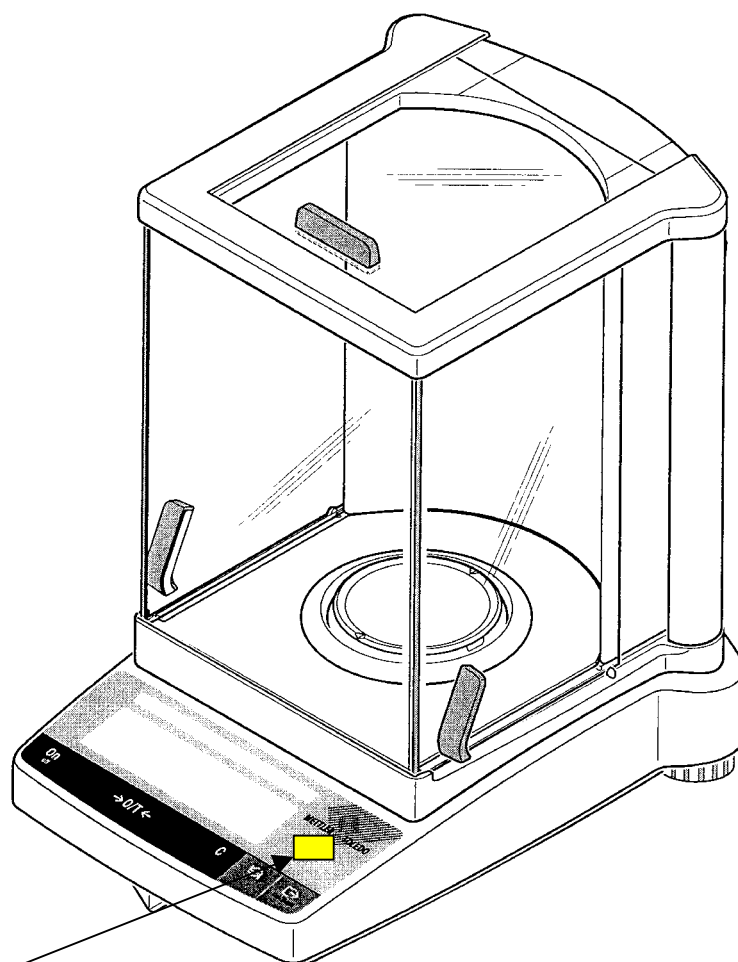

Ovjerni žig u obliku naljepnice