

KLASA: UP/I-960-03/98-07/89  
URBROJ: 558-03/9-99-1  
Zagreb, 06. svibnja 1999.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: PB
  - proizvođač mjerila: Mettler Toledo GmbH
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Albstadt, SR Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1009
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 27. studenog 1998. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti I , II , III, IIII ("Narodne novine" broj 51/93 ) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

Ravnatelj:  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Mettler Toledo d.o.o., 10000 Zagreb, Kraljevićeva 18
2. OMN -Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda
1. U Rješenju o tipnom odobrenju mjerila KLASA: UP/I-960-03/95-04/89; URBROJ: 558-03/1-95-4 u točki 1 popis tvorničkih oznaka mjerila dopunjava se tvorničkim oznakama PB-S i GB-S.
2. Sve kao u prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-960-03/95-04/89; URBROJ: 55802/1-95-4 pod službenom oznakom tipa mjerila HR M-2-1009 od 26. ožujka, 1996.

3. U točki 1 priloga rješenju o odobrenju tipa mjerila - "Opći podaci", popis odobrenih tipova mjerila dopunjava se i tipovima PB-S i GB-S.
4. U točki 2 - "Opis mjerila", iza riječi "PowerPac PP-B10" dodaju se i riječi: "ili Accupac B-S". Također se dodaje slijedeći pasus:  
"Izgled vaga PB-S i GB-S prikazan je na slikama 5 i 6. U tablici 2 prikazane su bitne značajke odobrenih PB-S i GB-S vaga razreda točnosti II"
5. U točki 2 - "Opis mjerila", dodaje se Tablica 2:

Tablica 2:

Tip vage	Max [g]	Min [g]	e [mg]	d [mg]	T [g]
PB153-S	151	0,02	10	1	-151
PB303-S	310	0,02	10	1	-310
PB303-S DR	310		10	10	-310
	60	0,02	10	1	
PB602-S	610	0,5	0,1	0,01	-610
GB802-S	810	0,5	0,1	0,01	-810
GB1302-S	1310	0,5	0,1	0,01	-1310
PB1501-S / GB1501-S	1510	5	0,1	0,1	-1510
PB1502-S	1510	0,5	0,1	0,01	-1510
GB2002-S	2100	0,5	0,1	0,01	-2100
PB3001-S / GB3001-S	3100	5	0,1	0,1	-3100
PB3002-S / GB3002-S	3100	0,5	0,1	0,01	-3100
PB3002-S DR / GB3002-S DR	3100		0,1	0,1	-3100
	600	0,5	0,1	0,01	
PB3002-S DR-A	3100	0,5	0,1	0,1	-3100
	600	0,5	0,1	0,01	
PB5001-S	5100	5	1	0,1	-5100
GB6001-S	6100	5	1	0,1	-6100
PB8001-S	8100	5	1	0,1	-8100

6. U točki 3 - "Tehnički podaci" na početku dodaju se retci:

**Maksimum opsega:**  $\leq 8100$  g  
**Ispitni podjeljak:**  $\geq 10$  mg

... slijedeći već postojeći redak nadopunjuje se navođenjem slijedećih podataka:

**Broj ispitnih podjeljaka:**  $n \leq 32100$  ( $n \leq 31000$  kod PB-S,GB-S)

- u retku "**Sučelje:**", iza riječi "LocalCAN (LC-B)" dodaju se i riječi "ili RS232C"
- u retku "**Napajanje:**", iza riječi "PowerPac PP-B10" dodaju se i riječi: "ili Accupac B-S"

7. U točki 4 - "Dokumentacija za identifikaciju mjerila i prikaz zaštite od neovlaštena pristupa", spisak slika nadopunjuje se niženavedenim popisom:

Slika 5. Vaga PB-S kapaciteta do 310 g


Slika 6. Vage PB-S i GB-S

Slika 7. Zaštita od neovlaštena pristupa samo za vage PB-S i GB-S


i slikama 5, 6 i 7 koje su u ovom prilogu rješenju o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila.

8. U točki 9 - "Način žigosanja vage", dodaje se slijedeća rečenica:


"Zaštita PB-S, GB-S vaga od neovlaštenog pristupa komponentama, koje korisnik ne smije rastavljati niti podešavati, vrši se pomoću dva zaštitna žiga - naljepnice, prema slici 7."

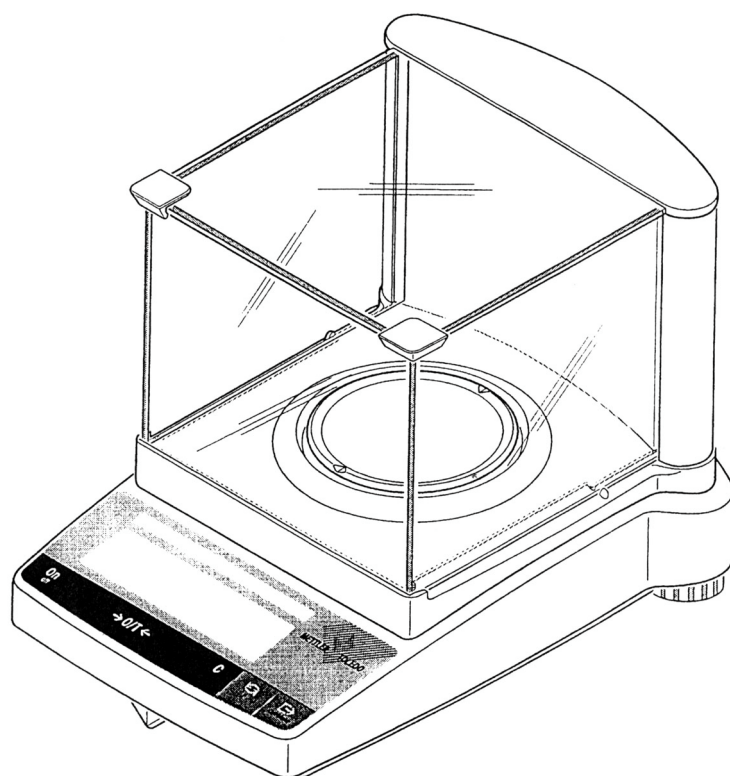

Slika 5. Vaga PB-S kapaciteta do 310 g

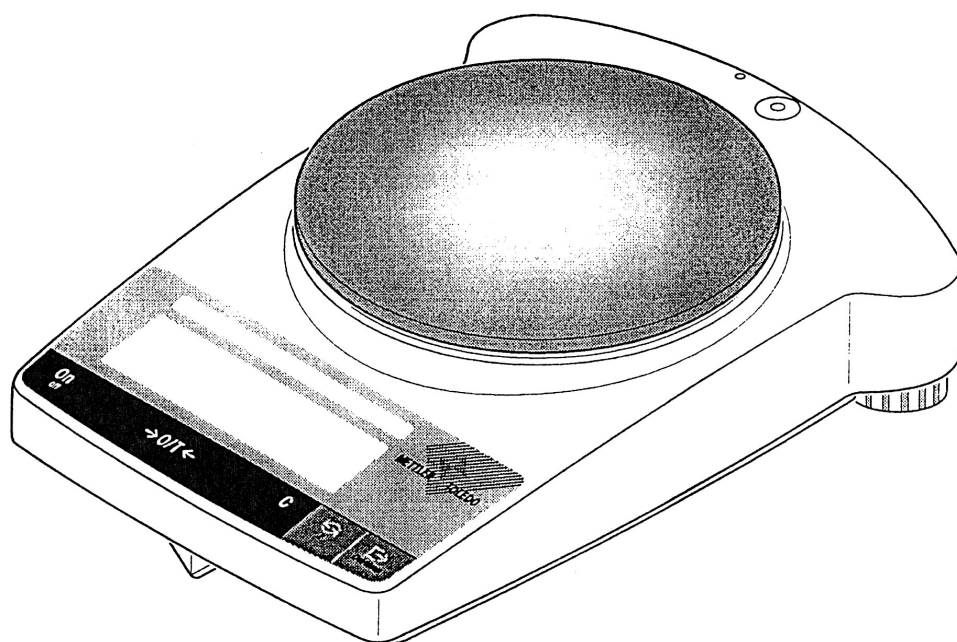

Slika 6. Vaga PB-S i GB-S

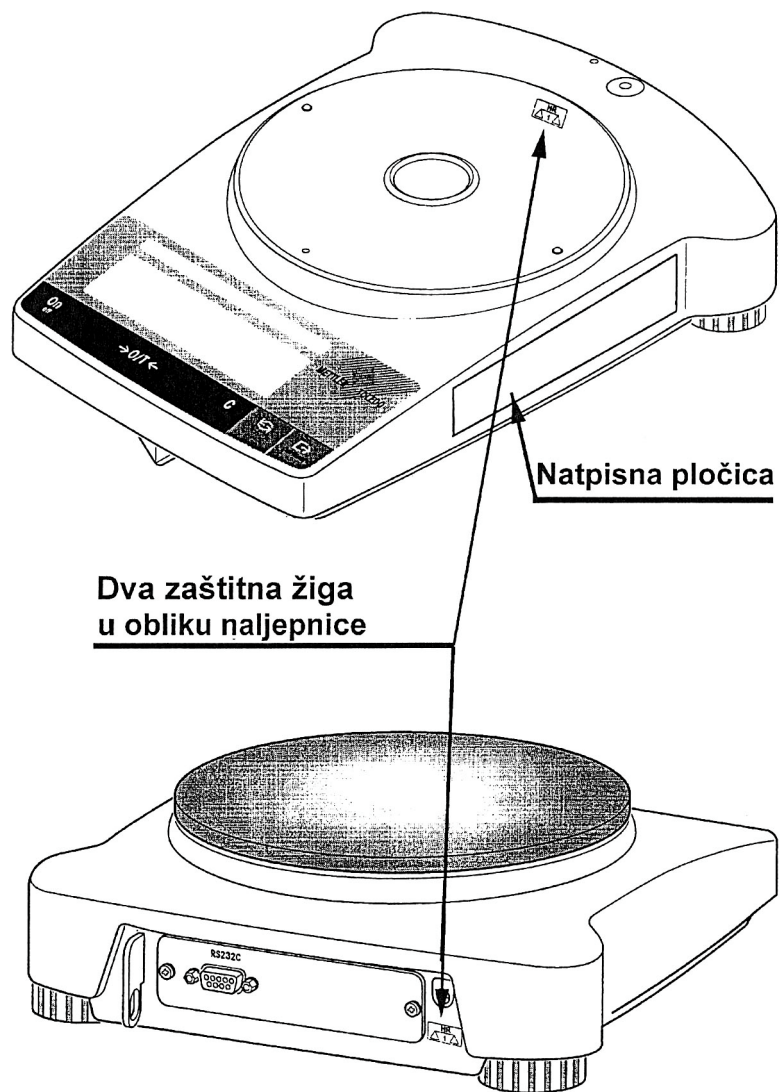

Slika 7. Zaštita od neovlaštena pristupa samo za vage PB-S i GB-S