

KLASA: UP/I-960-03/03-07/18
URBROJ: 558-03/9-03-2
Zagreb, 12. ožujka 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 81/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EXPLORER, VOYAGER, SCOUT, NAVIGATOR i CX xxx
 - proizvođač mjerila: OHAUS CORPORATION
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SAD
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1016
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 07. veljače 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, II Pračanska 2a
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/121, URBROJ:558-03/9-98-1, od 07. svibnja 1998. i dopunama tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/28, URBROJ:558-03/1-99-2, od 28. travnja 1999., KLASA:UP/I- 960-03/00-07/82, URBROJ:558-03/1-00-2, od 11. prosinca 2000. i KLASA:UP/I- 960-03/00-07/190, URBROJ:558-03/9-01-2, od 15. siječnja 2001. pod službenom oznakom HR M -2 -1016.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

- 2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila proizvodnje OHAUS CORPORATION – SAD, tvorničke oznake tipa CX xxx, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

TIP	CX xxx	CX xxx
Tazred točnosti	II	III
Max (kg)	1,5...150	1,5...300
e	10d	e=d
d	0,1g.....100g	0,5g.....1000g
n<	15 000	3 000
Tara	100%	100%
Temp.	10°C/30°C	-10°C /40°C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vaga tipa CX xxx te način ovjere i zaštite Kalibracioni prekidač

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

Slika 1




Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig za kliješta



Zaštitni žig u obliku naljepnice

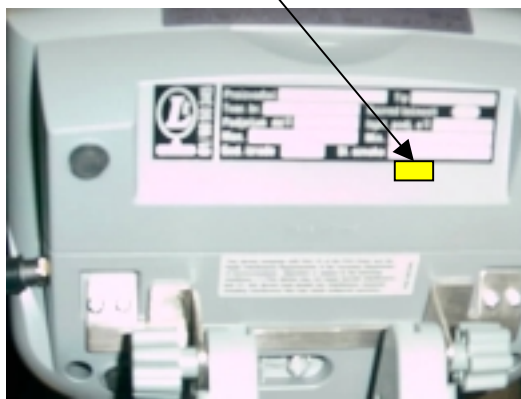

Slika 2

Kalibracioni prekidač

