



САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE  
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLE MENITE KOVINE  
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Бр. | 0214-2022  
Вр. |  
Ст. |

14.09.

1984 год. /год./лет.

11000 БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. b. 746, tel. 183-736

TELEX: 11020 YUZMBG

BC/D

Na osnovu člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 32/78) i člana 36. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", broj 9/84), na zahtev Agrovodjodina RO Interservis OOUR Uniagent-oprema Novi Sad, donosi se

### РЕШЕЊЕ

O odobrenju tipa merila

1. Odobrava se da se mogu podnositi na pregled merila:

- A. NAZIV MERILA: vaga klase tačnosti (II),
- B. OZNAKA TIPA MERILA: 1400 (1416 MP8),
- C. PROIZVODJAČ MERILA: Sartorius, SR Nemačka
- D. NAMENA MERILA: precizno merenje mase u procesu RADA,
- E. SLUŽBENA OZNAKA TIPA MERILA: M-2-4.

2. sastavni deo ovog rešenja čini prilog sa podacima o metrološkim svojstvima i upotrebljivosti merila i načinom žigosanja merila iz tačke 1. ovog rešenja.

3. Podnosilac zahteva je dužan da u zakonskom roku naknadi troškove postupka ispitivanja tipa merila u iznosu od: 15000 dinara.

4. žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

## O B R A Z L O Ž E N J E

Zahtevom: AGROVOJVODINE OOUR Uniagent oprema broj: 8231-138 od: 28.03.1984, traženo je donošenje rešenja o odobrenju tipa merila iz tačke 1. ovog rešenja. Izvršenim ispitivanjem tipa merila ustanovljeno je da je merilo podeseo za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove propisane Pravilnikom o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br.6/78).

Troškovi ispitivanja tipa merila naplaćuju se na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje tipa merila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i merila ("Službeni list SFRJ", br.44/84).


Na osnovu napred izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba mora biti taksirana sa 60.-dinara administrativne takse. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", broj 20/84), u iznosu od 16. i 60.- dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

OO:

- 1). MRS,
- 2). KIS,
- 3). OPKOP
- 4). Za "Glasnik" (6),
- 5). Pisarnici

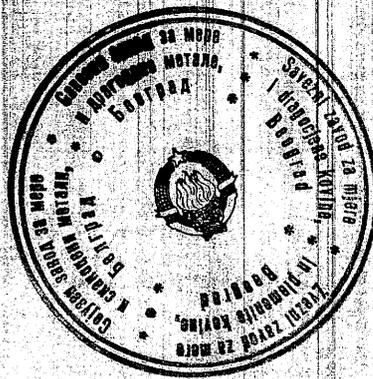

DIREKTOR,

PRILOG REŠENJU BR-o214-2o22

1. PODACI O METROLOŠKIM SVOJSTVIMA I UPOTREBLJIVOSTI  
MERILA

1.1. Vaga klase tačnosti (II)

1.2. Mirni opsezi:

Tip vage	Max	Podeljak d	Ispitni podeljak e
1416	300/3000g	0,01/0,1g	0,5 g

Mogućnost korišćenja tare je do Max merenja.

1.3. Referentni uslovi:

Temperatura od  $+ 10^{\circ}\text{C}$  do  $+ 30^{\circ}\text{C}$

Vlažnost vazduha od 15% do 85% r V

Nadmorska visina od - 500 do + 6000 m

Vibracije  $0,3 \text{ m/s}^2$

1.4. Merilo je zasnovano na principu magneta i indekcije čije se dejstvo meri i izkazuje preko AD pretvarača i nikro procesora.

Vaga poseduje izvedbe za kompjutersku obradu podataka i korišćenje tare do punog opsega.

1.5. Obavezni natpisi i oznake

-proizvodjač: "SARTORINS" SR Nemačka

-tip i broj: 1416 MP 8

-klasa tačnosti : (II)

-podeljak 0,01/0,1g

-ispitni podeljak "e" 0,5 g

-Max merenje: 300/3000 g

-Min merenje 25 g

-službena oznaka M-2-4

1.6. Vaga nije snabdevena uređajem za horizontalno postavljanje, pošto ista sa nagibom do 5% ne menja pokazivanje više od jednog ispitnog podeljka.

Vaga sa podešava sa etalonskim tegovima od 3 kg. koji se stavljaju na prijemnik tereta posle pritiska na dugme sa desne strane i pojave signala "C". Posle postavljanja etalonskih tegova ponovo se pritisne dugme i posle nekoliko sekundi vaga je podešena.

## 2. Način žigosanja

2.1. Žigosanje se vrši nalepnicom na osnovu tačke 6. Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova i o sadržini i obliku merenja o ispravnosti merila, koji se upotrebljavaju pri pregledu merila ( "Službeni list SFRJ", br. 26/84).

2.2. Nalepnica se stavlja sa prednje strane pored oznake tipa.