



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

NOT APPROVED

KLASA: UP/1-960-03/95-04/26
URBROJ: 558-03/1-95-2
Zagreb, 05. prosinca 1995.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev VAGE, donosi se

RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: ELEKTROMEHANIČKA VAGA
 - Tvornička oznaka mjerila: M6E1V I M15E1V
 - Proizvođač mjerila: VAGE
 - Mjesto i država: Zagreb, Republika Hrvatska
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1001/1
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 1 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

VAGE podnio je 29. lipnja 1995. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom mjerila mase s neautomatiziranim djelovanjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (III).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

Ravnatelj:

dr. Jakša Topić



Rješenje se smije umnožavati bez unošenja izmjena. Izvodi ili izmjene mogu se izvesti samo uz posebno odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa broj 960-03/92-04/26

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

- Prikaz na strani kupca dignut je na stup, što je zahtjevalo pojačanu izvedbu metalnog kućišta.
- Izmjenjen je raspored funkcijskih tipaka
- Promijenjena oznaka tipa i to :

M6E1 u M6E1V ,a M15E1 u M15E1V .

2.1. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA


Oznaka crteža/slike	sadržaj crteža /slike
slika 1	izmjere vage i način ovjeravanja
slika 2	izgled podignutog prikaza (displeja)
slika 3	nacrt natpisne pločice

3. Ostalo

Prema izvornom rješenju


Man.:

REPUBLIKA HRVATSKA
 DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
 OJBEK MERTILNE
 41000 ZAGREB
 S NADZORA



III Min 100g Max 15 kg e ± d ± 5g

MJELO		TIP IZMJENE		IZMJENA		NA ZAHTEJEV		DATUM		POTPIS	
PROJEKT	HODIĆ	MATERIJAL		ZAMJENA ZA							
CRTEZ	MARKOVIĆ	NAZIV	DISPLEJ (TIP M15E1V)								
KONTROLA	HODIĆ										
OVJERA											
DATUM		SKLOP		TIP							
		SASTAV		BROJ	M15E1V						LIST
											/

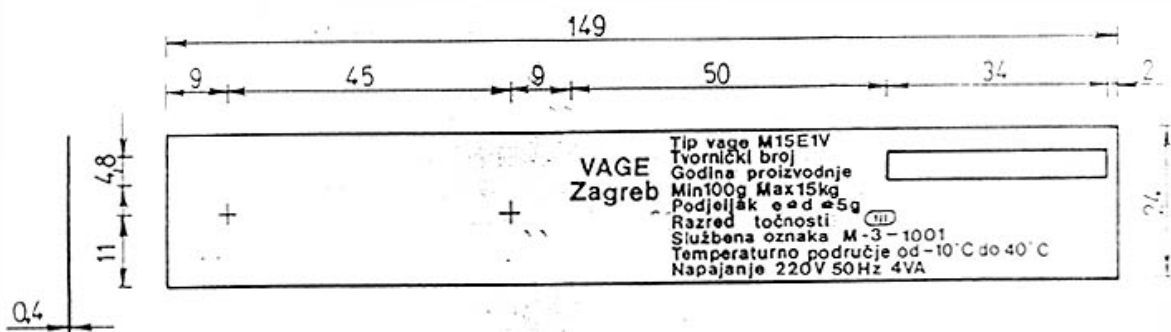

Natpis VAGE Zagreb slova visine 3mm, ostali tekst slova visine 2mm.

Na oznakama + izraditi provrt ϕ 4,8mm.

Tekst bijela boja podloga crna boja.

Površina za tvornički broj i godinu proizvodnje 34 x 4,8mm - bijela.

MJERILO		BROJ IZMJENE	IZMJENA	NA ZAHTEJEV	DATUM	POTPIS
PROJEKT	HODŽIĆ	MATERIJAL		ZAMJENA ZA		KOM
CRTEZ	MARKOVIĆ	<div style="text-align: center;"> <p>NAZIV</p> <p>NATPISNA PLOČICA</p> </div>				
KONTROLA	HODŽIĆ					
OVJERA						
DATUM						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>ZAGREB RAZVOJNO KONSTRUKCIJSKI IZUMIŠTVA I KONSTRUKCIJE</p> </div>		SKLOP	TIP			
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERILARSTVO		SASTAV	BROJ	M15E1V		
KONSTRUKCIJSKI		NETTO TEŽINA	PRIMJEOBA			