



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU  
I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/04-07/117  
URBROJ: 558-03/9-04-2  
Zagreb, 19. studenoga 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke FINEL d.o.o., Mostarska 10/a, 20350 Metković, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

- Odobrava se dopuna tipa mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: GRANIT, PROCESS I2
  - proizvođač mjerila: PRECIA MOLEN
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Privas, Francuska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1034
- Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
- Ovo rješenje o dopuni tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
- U prilogu ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka FINEL d.o.o., Mostarska 10/a, 20350 Metković, podnijela je ovom Zavodu, 20. rujna 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.


Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda

točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnosioca zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

- FINEL d.o.o., Mostarska 10/a,  
20350 Metković
- OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
- Pismohrana, ovdje
- Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA  
KLASA: UP/I-960-03/04-07/117  
URBROJ: 558-03/9-04-2

Stranica 1/3

PROIZVOĐAČ: PRECIA MOLEN

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : GRANIT, PROCESS I2

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1034

1. TEHNIČKI OPIS VAGE  
Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/03-07/126, URBROJ:558-03/9-04-1, od 29. ožujka 2004., pod službenom oznakom HR M-3-1160.
2. TEHNIČKI PODACI  
Na 1. ovjeru primat će se i vage tipa PROCESS I2 s mikroracunalom TCI, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	PROCESS I2
Razred točnosti	III
Broj MPS/proizvođač - tip	4/ATEX - CMI A951 2000 6m
Prijamnik tereta	Koš od nehrđajućeg čelika s pužem
Max (kg)	5000
e (kg)	5
Elektronički pokazno - upravljački uređaj (EPU)	u upravljačkom ormariću

- 2.1. Zaštita kalibracionih prekidača vrši se postavljanjem zaštitnih plastičnih plombi na poklopac upravljačkog ormarića u koji su ugrađeni EPU.

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage tipa PROCESS I2 ugrađenih u PZ Dingač Potomje te način oslanjanja na MPS
Slika 2	Izgled EPU tipa PROCESS I2, mikroracunala TCI i otvorenog poklopca upravljačkog ormarića te način ovjeravanja i zaštite natpisne pločice i kabla MPS


3. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.


*Mey*

Slika 2

Zaštitni žig u obliku naljepnice  
natpisne pločice




Ovjerni žig u obliku naljepnice



TCI



Poklopac upravljačkog ormarića s tri EPU  
tipa PROCESS 12



Zaštitni žig u obliku plastične plombe

*Man*



**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/117

URBROJ: 558-03/9-04-2


Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1034

Slika 1

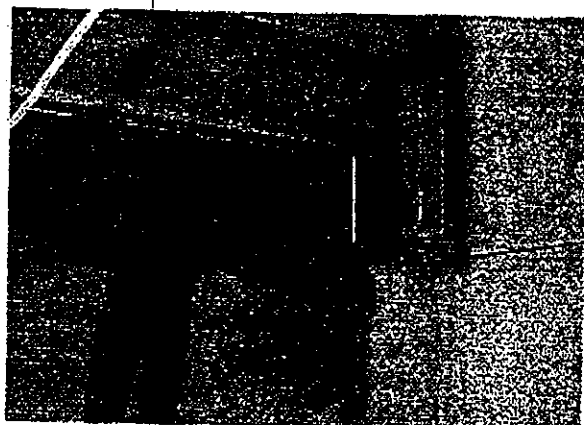

Način oslanjanja prijamnika tereta

*Bar...*

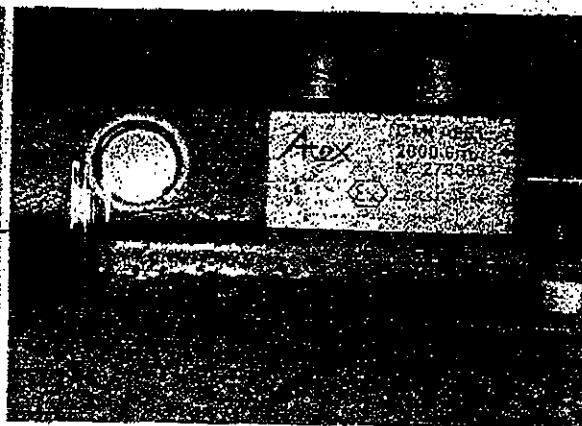

Mjerni pretvornik sile (MPS)