

NOT APPROVED

KLASA: UP/I-960-03/97-04/17
URBROJ: 558-03/1-97-2
Zagreb, 25. ožujka 1997.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke VAGE d.d. donosi se

R J E Š E N J E

o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - Tvornička oznaka mjerila: MPE...
 - Proizvođač mjerila: VAGE d.d.
 - Mjesto i država: Zagreb, Republika Hrvatska
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1035
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 1 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

Tvrtka "VAGE d.d." podnijela je 27. veljače 1997. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase – vage s neautomatskim funkcioniranjem r.t. (I), (II), (III), (IIII).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20 kn i 50 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

R a v n a t e l j:

dr. Jakša Topić

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa: KLASA: UP/I-960-03/95-04/58, URBROJ: 558-03/1-95-2, od 05. srpnja 1995. pod službenom oznakom HR M-3-1035.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Dozvoljava se podnošenje na ovjeru elektromehaničkih platformskih vaga, tip MPE... koje su opremljene s EPU tipa L 115; L 115V; L 116; L 215; L 216; L 225 i L 226.

Svi EPU osim L 115V odobreni su za upotrebu pod službenom oznakom HR M-3-1035 . EPU L 115V identičan je po elektroničkoj izgradnji EPU L 115 i L 116 ali je ograničenih mogućnosti jer je tipkovnica smanjena samo na tipke za NULA i TEST.

Konfiguracija, podešavanje i kalibracija EPU vrši se pomoću dodatne tipkovnice koja se prikopča na uređaj za vrijeme provođenja ovih funkcija a po uništenju zaštitnih žigova, otvaranju kućišta i uključivanju kratkospojnika (slike 1. i 2.).



EPU ugrađen je u kućište PC računala koje podatak o izmjerenoj masi na prijamniku mase obrađuje i po zadanom programu vrši potrebno pokazivanje na monitoru računala ili šalje na pisač, sprema u baze podataka iz kojih kasnije vrši obradu poslovanja putem vage te izradu potrebnih izvješća.

2.1. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža / slike	sadržaj crteža / slike
slika 1	izgled EPU, način ugradnje u kućište PC računala, mjesto ovjernog žiga u obliku naljepnice i način ovjeravnja
slika 2	način ovjeravanja

3. OSTALO



Prema izvornom rješenju.



L115V

VAGE - Zagreb
 Tip vage
 Tvornički broj
 Godina proizvodnje
 Min kg Max kg
 Podjeljak $d \equiv e \equiv$ kg
 Razred točnosti III
 Službena oznaka HR M-3-1035
 Temp. područje - 10 °C do + 40 °C
 Napajanje 220 V 50 Hz

SLIKA 1

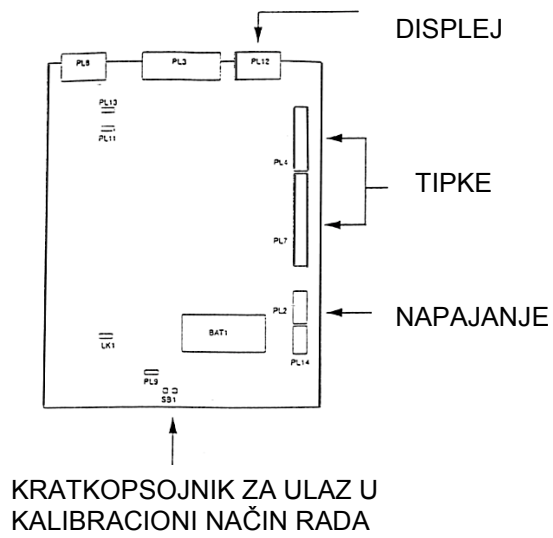

SLIKA 2