

KLASA: UP/I-960-03/03-07/105
URBROJ: 558-03/9-03-2
Zagreb, 22. listopada 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: LP-...-CW, LP-...CN, LP...CF i LP-...CNT, RN10...Tiger i RN00...Mini Tiger
 - proizvođač mjerila: Mettler-Toledo Changzhou Scale&System Ltd
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Changzhou, Jiangsu, NR Kina
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1101
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 19. kolovoza 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, Mandlova 3
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/105

URBROJ: 558-03/1-03-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO Changzhou Scale&System Ltd

Službena oznaka tipa:

MJERILO: Elektromehanička vaga tip LP-...-CW, LP-...-CN, LP-...-CF

HR M-3-1101

LP-...- CNT, RN10...Tiger II ii RN00...Mini Tiger

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/152,
URBROJ:558-03/1-98-1, od 04. veljače 1998.i dopuni tipnog odobrenja:
KLASA:UP/I- 960-03/01-07/194, URBROJ:558-03/9-01-2, od 05. prosinca 2001.,
pod službenom oznakom HR M -3 -1101.

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila mjeriteljskih značajki i oznakama tipa prema tablici 1.

Razred točnosti	III
Tip	RN10...Tiger II i RN00...Mini Tiger
Max	3 kg...30 kg
$n \leq$	3000
$e \geq$	1 g...20 g
Područje izjednačenja tare	-Max
Temperaturno područje rada	- 10 °C / +40 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Slika	Opis
Slika 1	Izgled vage RN10 155 CNTRS te način ovjeravanja

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja.


PRILOG DOPUNI TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/105

URBROJ: 558-03/1-03-2

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1101**

Slika 1

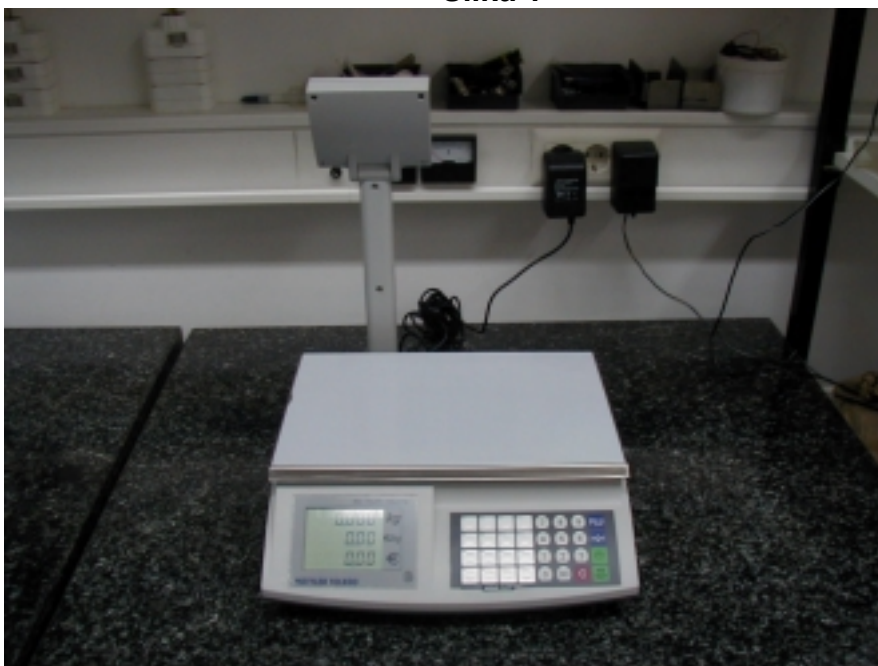

Ovjerni žig u obliku naljepnice

