



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/05-07/86
URBROJ: 558-03/6-05-2
Zagreb, 13. prosinca 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o, HR-10000 Zagreb, Mandlova 3, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DURA
 - proizvođač mjerila: Mettler – Toledo Inc.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 8606 Greifensee, Švicarska
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1169
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 22. srpnja 2015.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Objasnenje

Tvrtka METTLER TOLEDO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mandlova 3, podnijela je ovom Zavodu, 05. listopada 2005. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate izdan od Nederlands Meetinstituut, 3314 EG Dodrecht, Nizozemska.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (6 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrasec, dipl.ing



Dostaviti:

1. METTLER TOLEDO d.o.o., Mandlova 3, HR-10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/86

URBROJ: 558-03/6-05-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO GmbH

MJERILO: neautomatska elektromehanička vaga:

Tip: Dura

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1169

1. **TEHNIČKI OPIS VAGE**

Prema rješenju o tipnom odobrenju: Testl certificate izdan od Nederlands Meetinstituut, 3314 EG Dodrecht, Nizozemska broj TC6485 s rokom valjanosti 22. srpnja 2015.

2. **TEHNIČKI PODACI**

Na prvu ovjeru mogu se primati neautomatske elektromehaničke vage s skenerom tipa Dura, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tablica 1

Tip	DURA
Razred točnosti	III i IIII
Max	6 kg ... 30 kg
e = d	≥ 2 g
Min	100 g
Tara	≤ 100 % od Max
n ≤ n1/n2 ≤	6000 za jednodručne vage 3000 za višedručne vage
Temperaturno područje rada (°C)	10/40

3. **CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA**

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slija 4	Izgled vage tipa Dura Izgled vagajućeg modula Način ulaza u kalibraciju i izmjere vage Način spajanja vagajućeg modula i skenera u kućištu vage

Man

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJ TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/78

URBROJ: 558-03/6-05-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1173

4. NATPISI I OZNAKE

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- tvrтка ili znak proizvođača
- tip vage: IX...
- razred točnosti:
- službena oznaka tipa vage: HR M-3-1169
- serijski ili tvornički broj vage
- mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- ispitni podjeljak ($e = \dots$)
- temperaturno područje rada : (10 do 40) °C
- nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.



PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJ TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/78


URBROJ: 558-03/6-05-3

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1173

Slika 1

METTLER TOLEDO
Scanner Scale DURA



User Manual
and
Installation Guide

METTLER TOLEDO

©Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
16691000A 01/04 Printed in Germany

Handwritten signature

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJ TIPA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/05-07/78

URBROJ: 558-03/6-05-3

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1173**

Slika 2

DURA Magellan® 8200

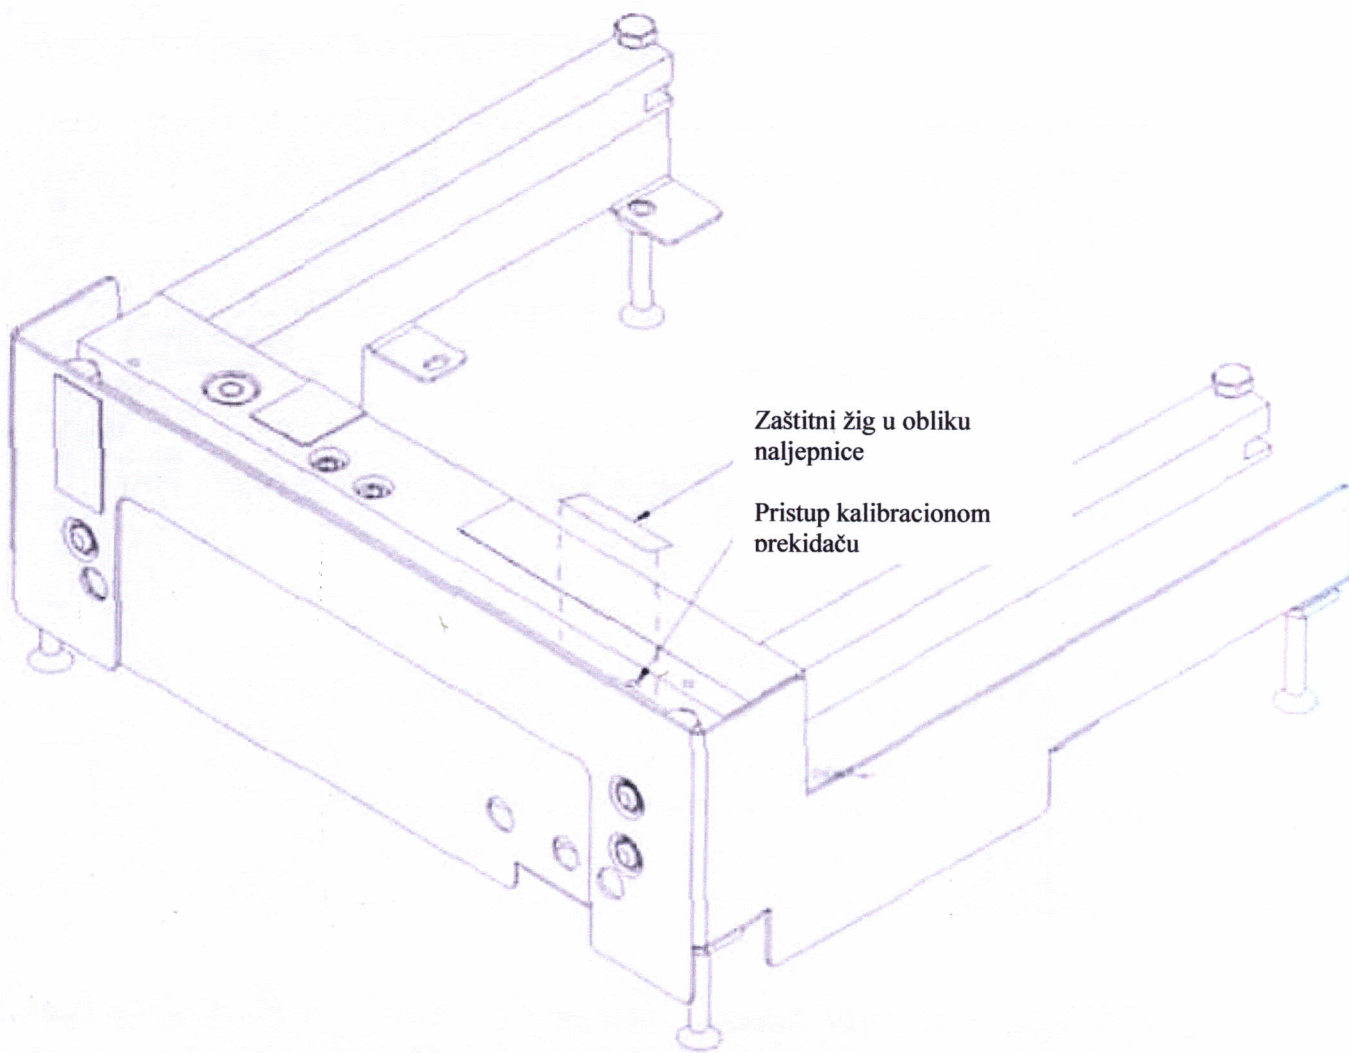

Handwritten signature

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJ TIPA MJERILA



KLASA: UP/I-960-03/05-07/78

URBROJ: 558-03/6-05-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1173

Slika 3

OPASKA: DUBINA ZA IZVIJAČ NE VIŠE od 20 mm



San



PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJ TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/78

URBROJ: 558-03/6-05-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1173

Slika 4



Mari