



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO**

KLASA: UP/I-960-03/06-07/126  
URBROJ: 558-03/6-06-2  
Zagreb, 29. prosinca 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o, HR-10000 Zagreb, Mandlova 3, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE**  
**O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: LP-..., LPe..., M-...
  - proizvođač mjerila: Mettler –Toledo (Albstadt) GmbH
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: 72458 Albstadt, SR Njemačka
  - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1198
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 05. prosinca 2015.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

**Obrazloženje**

Tvrtka METTLER TOLEDO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mandlova 3, podnijela je ovom Zavodu, 13. studenoga 2006. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate broj D-95-09-040 izdan od Notified Body broj 0102, SR Njemačka s rokom valjanosti 05. prosinca 2015.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

**Uputa o pravnom sredstvu**

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

**Dostaviti:**

1. METTLER TOLEDO d.o.o., Mandlova 3, HR-10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



**PRILOG RJEŠENJU ODOBRANJU TIPA MJERILA**

KLASA: UPA-030-03/06-07/126

URBROJ: 008-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO GmbH

MJERILO: neautomatska elektromehanička vaga:

tip: LP..., LPe..., M...

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1198

**1. TEHNIČKI OPIS VAGE**

Prema rješenju o tipnom odobrenju - EC type - approval certificate broj D-03-03-046 izdan od Njemačkog  
Društva 0102 BR Njemačka s datum valjanosti 05. prosinca 2015.

**2. TEHNIČKI PODACI**

Na prvu cijenu mogu se primiti neautomatske elektromehaničke vage tipa i mjerajskih zagađjki  
prema tablici u nastavku:

Tip	LP..., LPe..., M...
Razred točnosti	(III)
Max	3 kg ≤ Max ≤ 1500 kg
e	1 g... 500 g
n	6000e
n1 s	2000e za više područne vage
max/e1 s	7500e
Temperaturno područje rada [°C]	-10/40

**3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA**

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	izgled vage tipa LP..., LPe..., M... i važe izdane (S) slika 2 s log. prikazom težine

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

KLASA: UP/I-980-03/06-07/128

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1198

---

**4. NATPISI I OZNAKE**

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- tvrtka ili znak proizvođača
- tip vage: LP-..., LPe-..., M-...
- razred točnosti
- službena oznaka tipa vage: HR M-3-1198
- serijski ili tvornički broj vage
- mjerne područja "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- ispitni podjeljak ( $e = \dots$ )
- temperaturno područje rada : ( -10 do 40) °C
- nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

**5. OSTALO**

Prema izvornom tipnom odobrenju.



**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA**



KLASA: UP/I-960-03/06-07/128

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1198

**Slika 1**

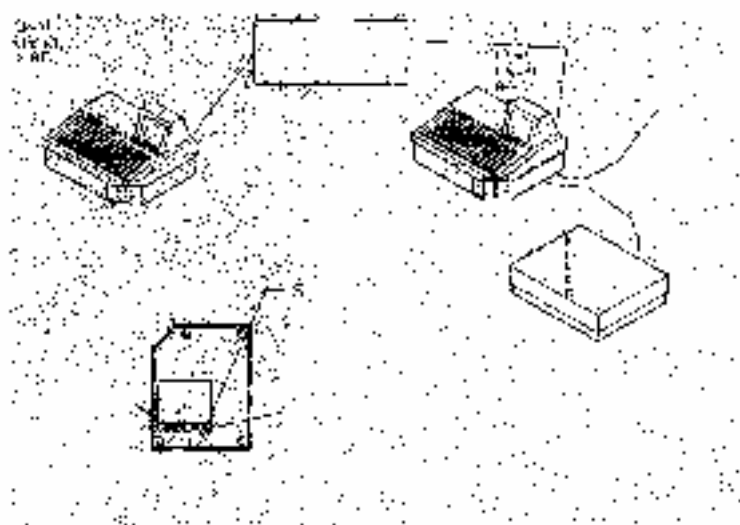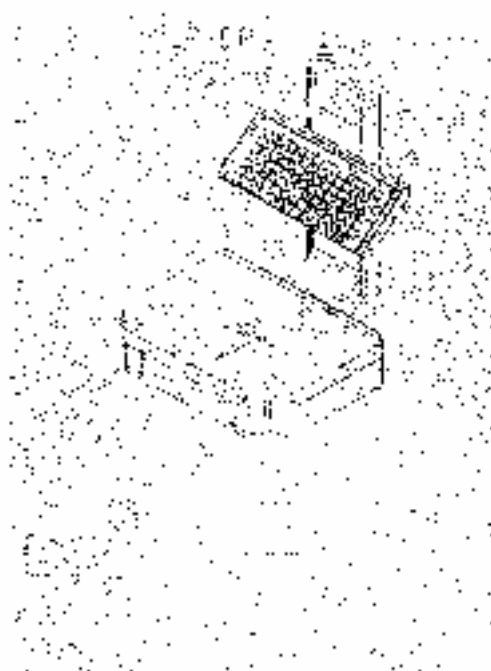

*Handwritten signature*

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

KLASA: UP/H-860-03/06-07/126

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1198

