



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/07-07/55
URBROJ: 558-02/1-4-08-1
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke Tehničar – servag d.o.o; Medulićeva 14; Zagreb, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: STILO Info 06, STILO Sonar 06 I STILO Color
 - proizvođač mjerila: Technilab SpA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: I 12100 Cuneo, Italija
 - službena oznaka mjerila: HR M – 3 - 1214
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka Tehničar – servag d.o.o; Medulićeva 14; Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 7. veljače 2008. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija i potrebni uzorci mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02) i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 1/05, 11/05 i 42/07) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)



Dostaviti:

1. Tehničar – servag d.o.o; Medulićeva 14; Zagreb, P.J. Zagreb, P.J. Osijek, P.J. Rijeka, P.J. Split
2. Pismohrana, ovdje
3. Glasilo Zavoda

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Tehničar – servag d.o.o, Medulićeva 14; Zagreb

Proizvođač mjerila: Technilab; I 12100 Cuneo; Italija

Vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga

Tvornička oznaka mjerila: STILO Info 06, STILO Sonar 06, STILO Color

Službena oznaka tipa: HR M-3-1214

2. Opis mjerila

Vaga tipa STILO ... namijenjena je za vaganje osoba. Pokazni uređaj dignut je na stup. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjerni pretvornik sile. Vaga je također opremljena s ultrazvučnim indikatorom visine osoba, i pisačem bona. Temeljem upisanog programa u mikroprocesoru vage, vaga može izračunavati i ispisivati procjenu idealne mase osobe ili neki drugi podatak po želji vlasnika vage. Vage se uključuju ubacivanjem žetona. Vage tipa STILO Info 06 mogu na vertikalom stupu indikatora visine ispisivati poruke po želji vlasnika vage. Vage mogu davati glasovne poruke po želji vlasnika vage.

U elektroničkom sklopu vage pojačava se izlazni signal mjernog pretvornika sile, i obavlja analogno/digitalno pretvaranje mjernog signala. Digitalni signal obrađuje se u procesoru, kako bi se dobio podatak o izmjerenoj masi. Pokazni uređaj, u izvedbi s tekućim kristalom ili LED, prikazuje iznos mase. Mjerilo se napaja preko pripadnog sklopa za napajanje 100 ... 240 V.

3. Tehnički podaci

3.1. Mjeriteljske značajke vage STILO Info 06, STILO Sonar 06, STILO Color

	STILO Info 06, STILO Sonar 06, STILO Color
Razred točnosti	III
max	150 kg
$e \geq$	50 g
$d =$	e
$n \leq$	3000
Temperaturni raspon	-10 °C / 40 °C

Mjerno područje s vrijednostima max, min, d, e i brojem ispitnih podjeljaka treba odabrati u skladu sa zahtjevima Pravilnika o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 1/05, 11/05 i 42/07), dodatka I, točaka 2. i 3.

3.2. Funkcije vage

- Početno namještanje ništičnog položaja (OIML R 76-1; T.2.7.2.4);
- Uređaj za zaštitu od preopterećenja;
- Uređaj za primanje žetona.

4. Natpisi i oznake

Na vagu se moraju postaviti slijedeći natpisi i oznake.

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vage
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vage
- 5) serijski ili tvornički broj vage
- 6) mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..." za svako mjerno područje
- 7) ispitni podjeljak ($e = \dots$) ili podjeljak ($d = \dots$) za svako mjerno područje
- 8) temperaturno područje rada
- 9) nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja

5. Postupak ovjeravanja vage

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 1/05, 11/05 i 42/07).

6. Način žigosanja vage

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštenog pristupa komponentama, koje korisnik ne smije rastavljati niti podešavati, te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vage.

Ovjera ispravnosti vage vrši se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice na uočljivo mjesto, tako da ne ometa nijednu funkciju vage.


Natpisna pločica se osigurava od skidanja plombom ili zaštitnom naljepnicom.

Zaštita od neovlaštenog pristupa komponentama, koje korisnik ne smije rastavljati niti podešavati, vrši se zaštitnim žigom u obliku naljepnice, koji se postavlja preko vijaka koji drže poklopac matične ploče na kojoj se nalazi sklopka za ulaz u servisni način rada.

7. tipovi vaga i način zaštite

7.1 Vage STILO Info 06 i STILO Sonar 06


godišnji ovjerni
žig

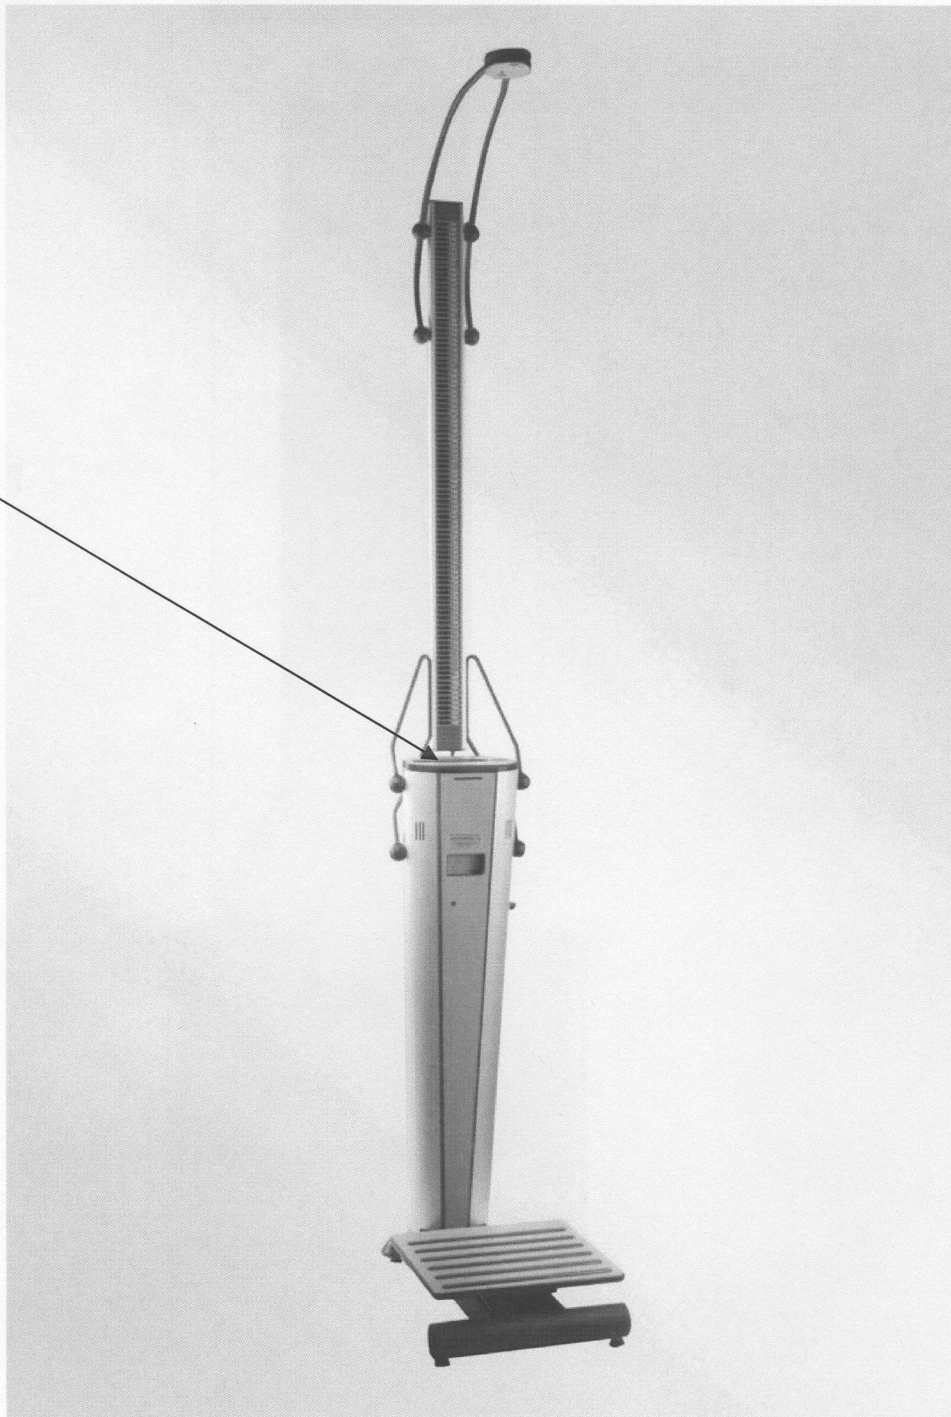

Izgled vaga STILO Info 06 i STILO Sonar 06. Razlika je tome što vaga STILO Info 06 može ispisivati poruke po želji vlasnika vage, na stupu indikatora visine. Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice postavlja se kod pokazivača mase.



7.2. Vage STILO Color

Godišnji ovjerni
žig

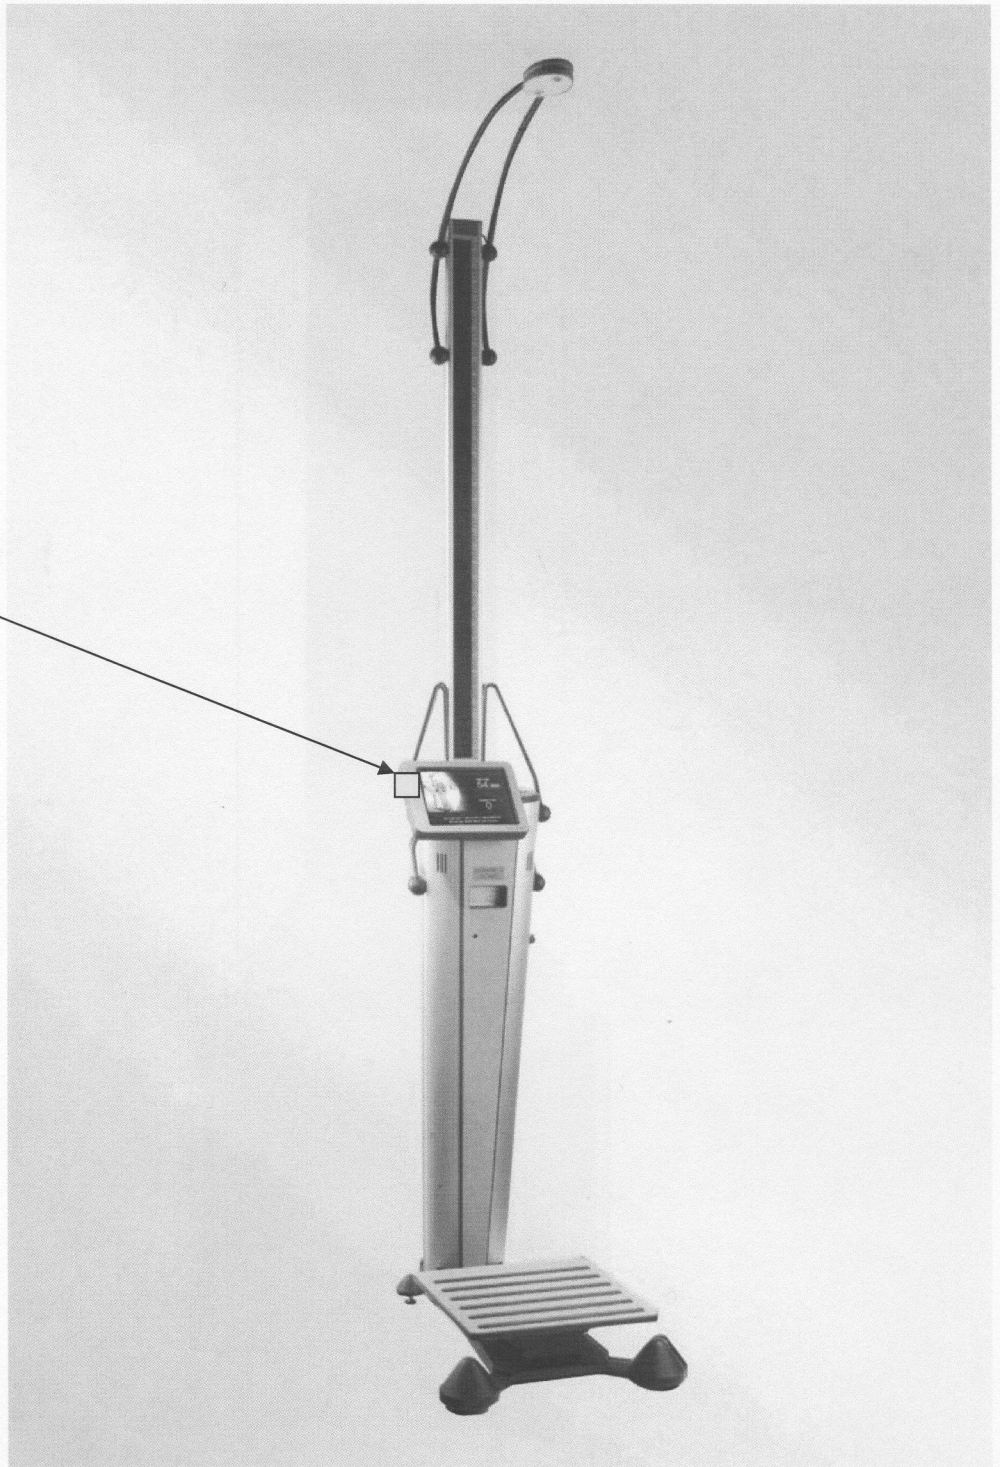

Izgled vage STILO Color. Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice postavlja se kod pokazivača mase.

7.3. način zaštite vaga STILO ...

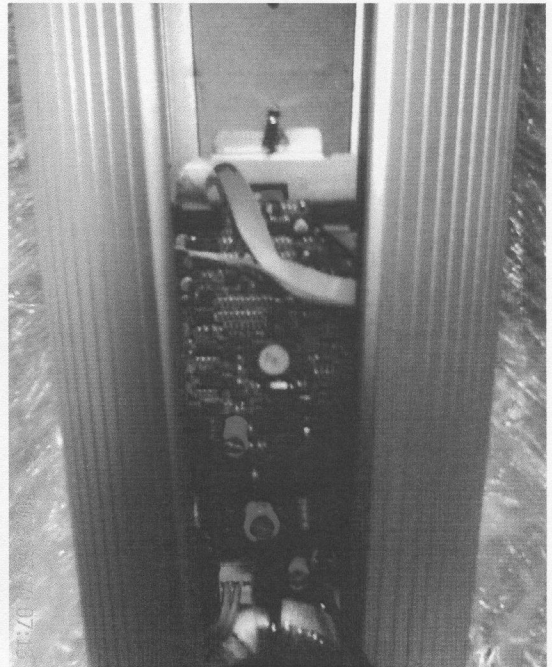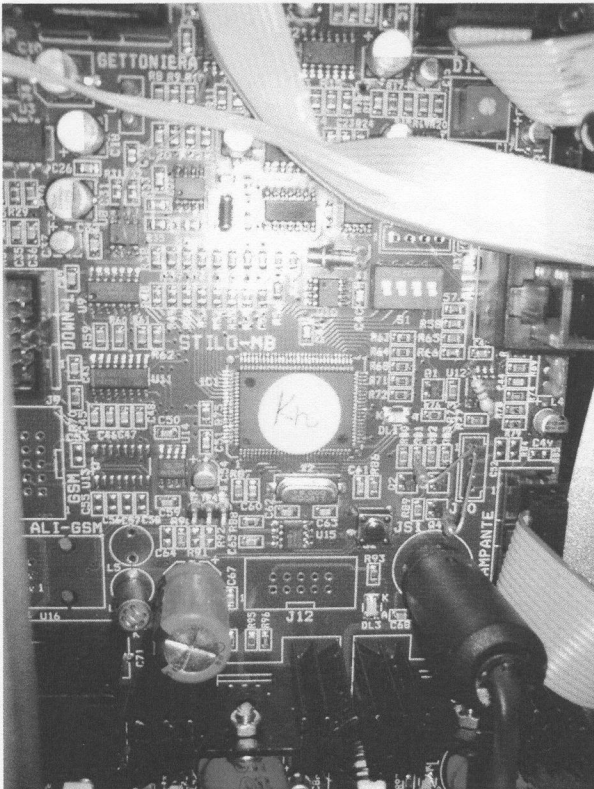

Izgled matične ploče vage s položajem tipkala za ulaz u servisni način rada i smještaj matične ploče u kućištu vage.

Na vagi se zaštićuju vijci koji drže poklopac koji prekriva matičnu ploču vage, zaštitnim žigovima u obliku naljepnice.

