

KLASA: UP/I-960-03/95-04/123
URBROJ: 558-03/1-96-2
Zagreb, 13. ožujka 1995.

NOT APPROVED

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke TEHNIČAR - SERVAG d.o.o. donosi se

R J E Š E N J E

o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - Tvornička oznaka mjerila: GAMA ET...
 - Proizvođač mjerila: LIBELA
 - Mjesto i država: Celje, Republika Slovenija
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-188
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 1 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

TEHNIČAR – SERVAG d.o.o. podnio je 24. studenog 1995. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase – vage s neautomatskim funkcioniranjem r.t. (I), (II), (III), (IIII).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

R a v n a t e l j:

dr. Jakša Topić

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa broj 0201-3317/91 od 24.051991. godine.

2 TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Vage imaju LCD prikaze.

Vage tipa ET2 i ET4 imaju mrežno i akumulatorsko napajanje, a vage ET1 i ET4 imaju baterijsko napajanje 9V.

Vage tipa ET3 i ET 4 imaju uzdignute prikaze.

Uz prikaz osnovne cijene nalaze se indikatori unosa tare, fiksne tare, fiksne cijene i korištenja drugog karaktera pojedinih tipaka.

Uz prikaz mase nalazi se indikator niskog napona baterija.

Mogućnost programiranja 36 cijena s direktnim pozivom (PLU).

Pretvornici mase su ARBE: MB-N za vage Max = 6 kg i MBA 20 kg za vage Max = 15 kg.

2.1. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža / slike	sadržaj crteža / slike
slika 1	izgled vaga
slika 2	opis vaga
slika 3	način ovjeravanja i natpisna pločica

3. OSTALO

Prema izvornom rješenju.


ELEKTRONSKE VAGE TIP GAMA ET1, ET2, ET3, ET4

IZGLED MJERILA I MJERE

1. POKAZIVAČ MASE
2. POKAZIVAČ CIJENE
3. POKAZIVAČ IZNOSA
4. PLU TASTATURA
5. NUMERIČKA TASTATURA
6. ZRAČNI MEHURIČ
7. LETNI ŽIG
8. NASTAVLJIVE NOŽICE
9. PRIJEMNIK MASE
10. NATPISNA PLOČICA
11. OBOJESTRANI POKAZIVAČ

Napomena: elementi crtani - - - predstavljaju varijantu vaga ET 3 i ET 4

POZICIJA	MJERE (mm)
A	360
B	450
C	520
D	140




SLIKA 2

ELEKTRONSKE VAGE GAMA ET

NAMJEŠTANJE KONTROLNIH ŽIGOVA I IZGLED NATPISNE PLOČICE

1. NATPISNA PLOČICA
2. ZAŠTITNI ŽIG
3. ZAŠTITNI ŽIG NA NATPISNE PLOČICE
4. GODIŠNJI ŽIG NALJEPNICA

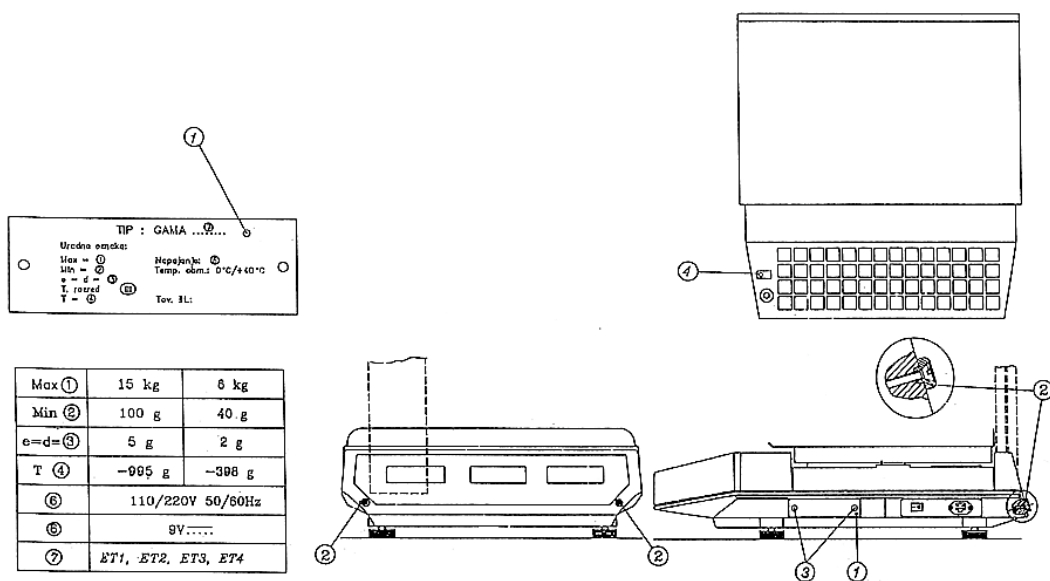

SLIKA 3