

NOT APPROVED

UKINUTO 01.01.2003.

KLASA: UP/I-960-03/97-07/46
URBROJ: 558-03/9-99-2
Zagreb, 19. srpnja 1999

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička automatska vaga s diskontinuiranim mjerenjem
 - tvornička oznaka mjerila: AUT D2 - D1, ADT D2-D1 i PUT D2-D1
 - proizvođač mjerila: Libela Elsi d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje, R.Slovenija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-5-27
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 23. lipnja 1999 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za vage s automatskim funkcioniranjem ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR SERVAG d.o.o.,
10000 Zagreb, Medulićeva 14
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa broj 0201 - 3710/90, od 25. ožujka 1991. pod službenom oznakom M - 5 - 27 i rješenju o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila klasabroj UP/I-03/97-04/146, urbroj 558-03/1-98-1, od 18. kolovoza 1998.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenim rješenjima osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki navedenih u tablici u nastavku:

Tip	AUT D2-D1, ADT D2-D1 i PUT D2-D1
Razred točnosti	A i B
Max (kg)	1...4000
Min	(20%...60%) Max
Broj mjernih pretvornika sile	1...4
Elektronički pokazno-upravljački uređaj	DPA 1000, DPA 2000 i DPA 3T i DPA 3E
n ≤	3000
Tara ≤	Max
Napajanje	AC220 V / 50 Hz, DC 12V ili DC 24V
Temperaturno područje rada	- 10 °C / +40 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
60.88.0014 Slika 1	Zaštita od neovlaštena pristupa i način žigosanja Mogući izbor tvorničkih oznaka tipa

4. Ostalo

Prema izvornom rješenju.

1 PROIZVOĐAČ:


LIBELA ELSI

Opekarniška 2
3000 CELJE, SLOVENIJA


2 VRSTA MJERILA:

ELEKTROMEHANIČKA AUTOMATSKA VAGA r. t. A i B.

3 TVORNIČKA OZNAKA MJERILA:

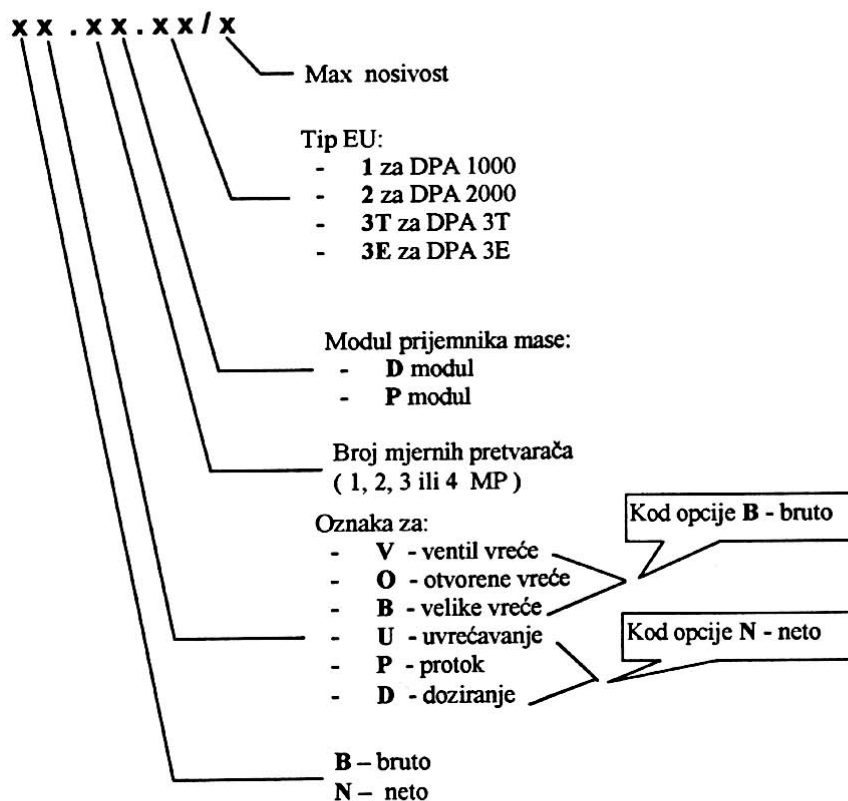

Primjer tvorničke oznake mjerila: BO.1D.3T/ 5kg



Objekt: AUTOMATSKA VAGA		Naziv: Žiogosanje vage	
Word/Over At/Hrv	Ime	Datum	Podpis
Konstruiral	Stopinšek	07. 05. 99	<i>delupis</i>
Pregledal	Valenčič	07. 05. 99	
Sprememba			
			LIBELA ELSI
			Koda: 60.88.0014
			L/Listov 1/1