

KLASA: UP/I-960-03/03-07/109

URBROJ: 558-03/7-03-3

Zagreb, 17. listopada 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke Fokus Medical d.o.o., Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **TIPNO ODOBRENJE**

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: tlakomjer za mjerenje krvnog tlaka
  - tvornička oznaka mjerila: VITAMAT V3
  - proizvođač mjerila: KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Asperg, Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR P-3-1102
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka Fokus Medical d.o.o, Rapska bb, Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 28. kolovoza 2003. zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvešćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02) i da je prikladno za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

#### **RAVNATELJ**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Fokus Medical d.o.o., Rapska bb, 10000 Zagreb
2. OMP-područna jedinica Zagreb, Rijeka, Osijek, Split
3. Glasilo Zavoda
4. Pismohrana, ovdje

**DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 78**

Str. 1/5

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/03-07/109

URBROJ: 558-03/7-03-3

**PROIZVOĐAČ:** KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co.

**MJERILO:** Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka  
Vitamat V3

**Službena oznaka tipa:**  
**HR P-3-1102**

**TEHNIČKI OPIS ELEKTRONIČKOG AUTOMATSKOG PRIJENOSNOG TLAKOMJERA  
ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA TIP VITAMAT V3**

**1. Namjena**

Elektronički automatski prijenosni tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka tip Vitamat V3 namijenjen je za mjerjenje krvnog tlaka i bila (pulsa) tj. broj otkucaja srca odraslih osoba.

**2. Primjenjeni tehnički propisi i norme**

- 2.1. Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" br. 93/96)
- 2.2. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02.).
- 2.3. Naredba o mjerilima nad kojima se provodi mjeriteljski nadzor ("Narodne novine" br. 100/03.)

**3. Mjerno načelo**

Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka tip Vitamat V3 je potpuno automatski elektronički uređaj koji mjeri sistolički i dijastolički arterijski (arteria brachialis) krvni tlak te bilo (broj otkucaja srca) odraslih osoba koristeći neinvazivnu oscilometričku metodu Riva-Rocci-Korotkoff.

Mjerenje se provodi pri padajućem tlaku u orukvici na nadlaktici ruke. Orukvica (manžeta) služi kao osjetilo za registriranje oscilacija. Prenesene oscilacije dolaze u osjetilo tlaka i izražavaju se kao mjerne vrijednosti putem mikroprocesora.

Trenutačni tlak u orukvici neprekidno se prikazuje na pokaznom uređaju sve do završetka mjerjenja. Tlakomjer ima odgovarajuću elektromehaničku crpku. Poslije završenog mjerjenja, izmjerene vrijednosti tlaka i bila (pulsa) prikazuju se na pokaznom uređaju.

**DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 78**

---

Str. 2/5

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/03-07/109

URBROJ: 558-03/7-03-3

**PROIZVOĐAČ:** KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co.

**MJERILO:** Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka  
Vitamat V3

**Službena oznaka tipa:**  
**HR P-3-1102**

---

Napuhavanje i ispuštanje tlaka, iskazivanje rezultata mjerjenja kao i iskazivanje svih drugih podataka u cijelosti je automatizirano. Za napuhavanje uređaj koristi tzv. Fully Fuzzy Logic metodu tj. automatski prepoznaće na koju početnu vrijednost je potrebno napuhati orukvicu (manžetu).

Prije svakog pojedinačnog mjerjenja krvnog tlaka i prije svakog poziva mjernog modusa, automatski se provodi namještanje ništice dijela za mjerjenje tlaka.

Tlakomjer tip Vitamat V3 ima memoriju putem koje pamti najviše 8 rezultata mjerjenja.

Uređaj je smješten u plastično kućište, a napajanje je ostvareno preko alkalnih baterija.

Obujmica za nadlakticu ruke izrađena je od sintetičke tkanine. Unutar nje nalazi se gumeni balon spojen na mjernu jedinicu i automatski regulator optimalnog tlaka prazne orukvice.

Način iskazivanja rezultata je brojčani.

Rezultat mjerjenja tlaka očitava se na brojčanom pokazivaču s dva seta brojčanih vrijednosti (za sistolički i dijastolički tlak) te za bilo (puls).

Uređaj se isključuje automatski nakon jedne minute.

## 5. Mjerno-tehnički podaci

Uređaj se sastoji od sljedećih osnovnih dijelova:

- plastičnog kućišta
- elektroničke ploče s elementima
- LCD- displeja
- elektromotora s crpkom
- ventila za brzo kontrolirano ispuštanje zraka elektronički reguliranog
- mjernog osjetila tlaka (senzora)
- središnje mikroprocesorske jedinice (CPJ)
- prekidača (tipke) za uključivanje i isključivanje oznaće «POWER»
- tipke «MEMORY» za pamćenje do 8 rezultata mjerjenja
- izvora napajanja su 4 alkalne baterije tip LR 06 (AA) od 1,5 V.

**DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 78**

Str. 3/5

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/03-07/109

URBROJ: 558-03/7-03-3

**PROIZVOĐAČ:** KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co.

**MJERILO:** Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka  
Vitamat V3

**Službena oznaka tipa:**  
**HR P-3-1102**

Način iskazivanja rezultata mjerjenja je brojčani. Tlakomjer mjeri dijastolički i sistolički krvni tlak izražen u mm Hg kao i broj otkucaja bila (srca).

Mjerno područje:

Sistolički tlak od 50-250 mm Hg

Diastolički tlak od 40-180 mm Hg

Puls (bilo) od 40-160 otkucaja/minuti

Podizanja tlaka u sustavu izведен je s pomoću elektromehaničke crpke sa samoregulacijom ništičnog tlaka obujmice.

Ispuštanje zraka (automatsko smanjivanje tlaka s mehaničkim povratom) regulirano je u području od cca 4 mm Hg/s.

Rezolucija mjerjenja na pokaznom uređaju iznosi 1 mm Hg.

Točnost mjerjenja krvnog tlaka iznosi  $\pm 3$  mm Hg, a za bilo (puls) točnost očitanja je  $\pm 5\%$  od izmjerene vrijednosti.

Temperaturni upotrebni interval iznosi 10-40 °C uz relativnu vlažnost od 15 % do 90 %.

**6. Granice dopuštene pogreške**

Prema Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02), granice dopuštene pogreške (GDP) pokazivanja tlakomjera za svaku vrijednost tlaka u mjernom području ne smiju iznositi više od  $\pm 3,00$  mm Hg ( $\pm 0,4$  kPa) kod prve ovjere ili  $\pm 3,75$  mm Hg ( $\pm 0,5$  kPa) kod ponovne ovjere tlakomjera.

Promjene pokazivanja tlakomjera ne smiju prelaziti apsolutnu vrijednost najveće dopuštene pogreške od 3,00 mm Hg (0,4 kPa) kod prve ovjere ili 3,75 mm Hg (0,5 kPa) kod ponovne ovjere tlakomjera.

Za temperature između 15 °C i 25 °C najveće dopuštene pogreške ne smiju prelaziti apsolutnu vrijednost granice dopuštene pogreške od 3,00 mm Hg (0,4 kPa) kod prve ovjere ili 3,75 mm Hg (0,5 kPa) kod ponovne ovjere tlakomjera.

**7. Natpisi i oznaake**

Natpisi i oznaake moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

Natpisi i oznaake na tlakomjeru moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i napisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

**DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 78**

Str. 4/5

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/03-07/109

URBROJ: 558-03/7-03-3

**PROIZVOĐAČ:** KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co.

**MJERILO:** Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka  
Vitamat V3

**Službena oznaka tipa:**  
**HR P-3-1102**

Natpisi i oznake na tlakomjeru moraju biti napisani u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02).

- a. tip tlakomjera: Vitamat V3 nalazi se na napisan na prednjoj plohi kućišta
- b. naziv proizvođača: KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co. nalazi se na naljepnici na donjoj plohi kućišta
- c. tvornički (serijski broj) tlakomjera: nalazi se napisan na naljepnici u prostoru za smještaj baterija.

**8. Ovjeravanje i žigosanje**

Tlakomjeri za krvni tlak tip Vitamat V3 koji udovoljavaju odredbama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak ("Narodne novine" br. 18/02), kao i zahtjevima ovog rješenja, žigosat će se postavljanjem službenih ovjernih žigova na ona mjesta na tlakomjeru koja je potrebno zaštititi od neovlaštenog pristupa dijelovima s pomoću kojih se može utjecati na točnost mjerjenja. Žigovi se moraju postaviti tako da se zahvati kojima se može utjecati na točnost tlakomjera mogu obaviti tek po njihovu uništenju.

Ovjerni žig Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo u obliku naljepnice postavlja se prema Naredbi o ovjernim žigovima i ispravama kojima se potvrđuje ispravnost mjerila ("Narodne novine" br. 25/02.) obvezatno na gornju bočnu plohu gornjeg dijela kućišta (vidi sliku 1).

Ovjerni žig vrijedi 1 (jednu) godinu.

Za ovjeravanje tlakomjera za mjerjenje krvnog tlaka tip Vitamat V3 potrebno je prije postupka ovjeravanja odvojiti orukvicu (manžetu) od samog uređaja. Kad je orukvica odvojena vidi se mjesto na poledini uređaja za priključak pomoću crijeva na etalon. Prije ovjeravanja potrebno je namjestiti tzv. "umjerni (kalibracijski) kod".

Ovjeravanje tlakomjera obavlja se spajanjem etalona na tlakomjer i zadavanjem vanjskog tlaka prema propisanoj proceduri za ovjeravanje tlakomjera za krvni tlak.

**9. Posebne napomene**

Ovo tipno odobrenje ne obuhvaća ispitivanja iz područja medicinskih propisa.

Ovo tipno odobrenje ne odnosi se na propise iz područja sigurnosti i protuexplozijske zaštite.

Zaštitna prava bilo koje vrste ne odnose se na ovo tipno odobrenje.

**DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 78**

Str. 5/5

**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/03-07/109

URBROJ: 558-03/7-03-3

**PROIZVOĐAČ:** KaWe (Kirchner & Wilhelm) GmbH+Co.


**MJERILO:** Tlakomjer za mjerjenje krvnog tlaka  
Vitamat V3

**Službena oznaka tipa:**  
**HR P-3-1102**

10. Slike i crteži

Slika/crtež	Sadržaj slike/crteža
Slika 1	Izgled tlakomjera tip Vitamat V3 s prikazom mesta za smještaj ovjerne naljepnice

mjesto za smještaj ovjerne naljepnice

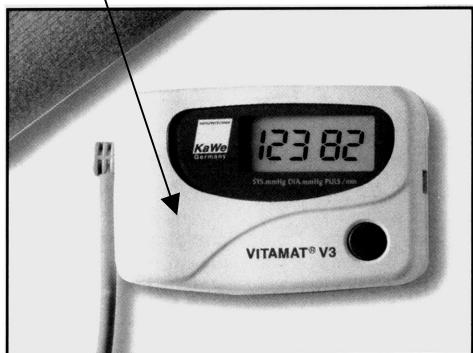

Slika 1: Izgled tlakomjera tip Vitamat V3 s prikazom mesta za smještaj ovjerne naljepnice