

KLASA: UP/I-960-03/03-07/6
URBROJ: 558-03/3-03-2
Zagreb, 7. veljače 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke [Danfoss d.o.o., Zagreb](#), radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: [Računska jedinica mjerila toplinske energije](#)
 - tvornička oznaka mjerila: [INFOCAL 5](#)
 - proizvođač mjerila: [HYDROMETER GmbH](#)
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: [Ansbach, Njemačka](#)
 - službena oznaka tipa mjerila: [HR Q-3-1006](#)
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka [Danfoss d.o.o., Zagreb](#), podnijela je ovom Zavodu, [21. siječnja 2003.](#) godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane [Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije](#) ("Narodne novine" broj [25/00](#)) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu ([1 str.](#))

R A V N A T E L J

dr. sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. [Danfoss d.o.o., Heinzelova 6a, 10000 Zagreb](#)
2. OMP PJ– Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI PODACI

Kao u prilogu tipnog odobrenja klasa: UP/I-960-03/01-07/68, urbroj: 558-03/4-01-1, od 1. ožujka 2001. godine, pod službenom oznakom tipa mjerila HR Q-3-1006, osim što je računsku jedinicu mjerila toplinske energije tipa INFOCAL 5 prije proizvodio Danfoss A/S, Nordborg, Danska, a sada HYDROMETER GmbH, Ansbach, Njemačka pod istom oznakom tipa, istih tehničkih i mjeriteljskih značajki te istih natpisa i oznaka.


2. ZAŠTITA OD NEOVLAŠTENA PRISTUPA

Kao u prilogu navedenog tipnog odobrenja, osim što je na gornjem dijelu stražnje strane računске jedinice mjerila toplinske energije tipa INFOCAL 5 dodan jedan otvor koji omogućava pristup mjeriteljskim parametrima, pa je i njega, nakon ovjeravanja potrebno zaštititi od neovlaštena pristupa sa zaštitnim žigom u obliku naljepnice (slika 1).

3. OSTALO

Kao u prilogu navedenog tipnog odobrenja.

zaštitni žigovi u obliku
naljepnice

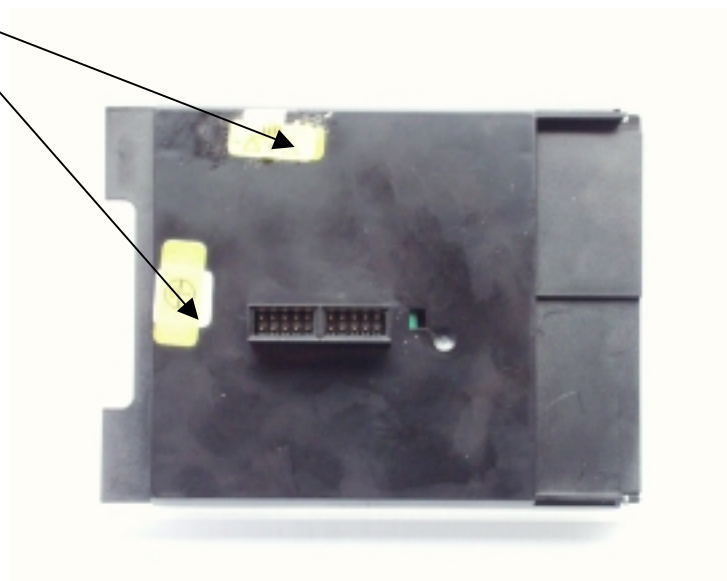

Slika 1: Zaštita od neovlaštena pristupa mjeriteljskim parametrima računске jedinice INFOCAL 5 nakon ovjeravanja